



2006/10/20 アイラボ (AI Laboratory)

G2000 FR2-Ver1.5 (AED本体がVer1.5で、ガイドライン2000の設定をシミュレート)

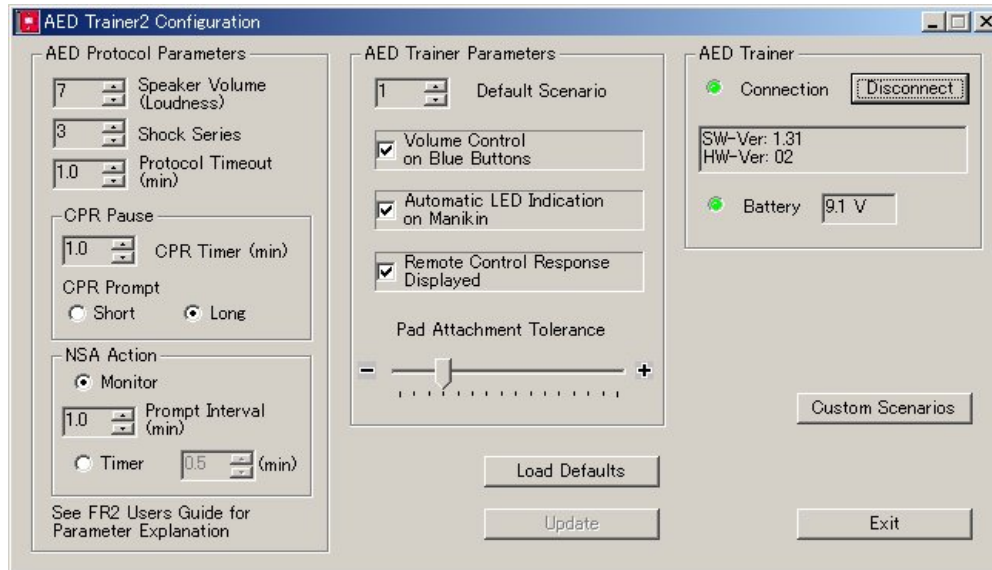

G2005 FR2-Ver1.5 (AED本体がVer1.5で、ガイドライン2005の設定をシミュレート)

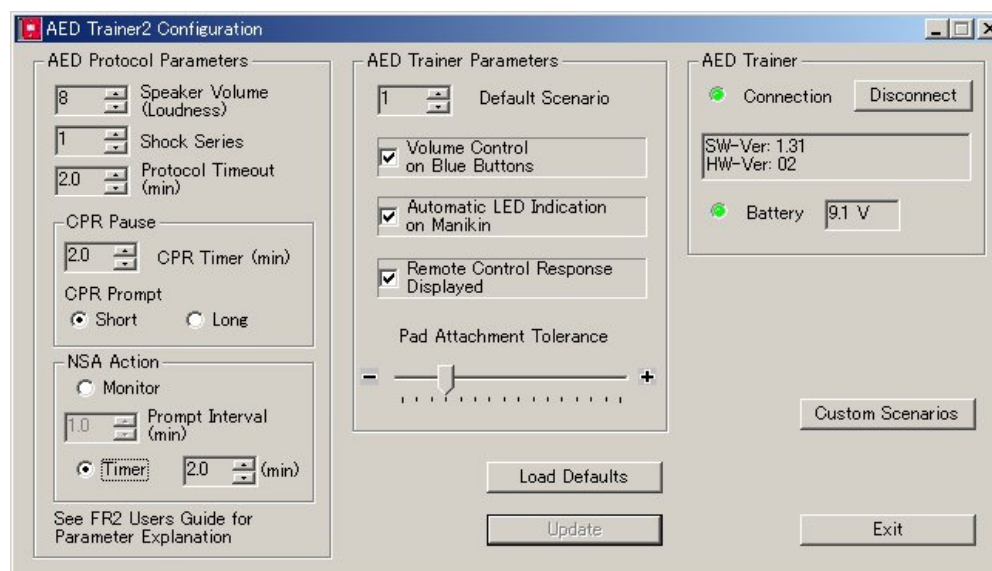

G2005 FR2-Ver1.6 (AED本体がVer1.6で、ガイドライン2005設定をシミュレート)

